

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 14 czerwca 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz kardiowerterów – **znak sprawy 28/18**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody z jednym rodzajem odległości między biegunami: 2/8/2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrody o odległościach między biegunami 2/6/2 i 2/8/2 do wyboru. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektrody typu flutter, w wersji elektrody dedykowanej do ablacji cieśni, o długości 95cm i o zwiększonej stabilności bocznej?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

dotyczy zadania nr 12

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt 21 dot. warunków badania MRI w stosunku do złącza IS4, gdyż jest to złącze elektrody lewokomorowej czteropolowej i nie jest częścią układu dwujamowego (ICD DR)?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

5. Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo, prosimy o dopuszczenie koszulek ZBROJONYCH, spełniających WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE a jedyna różnica to długość koszulki o 1cm – wymagane 63cm (posiadamy 62cm) oraz 81cm (posiadamy 80cm) dostępnej w 3 krzywiznach do wyboru i rozmiarach 8Fr/ 8.5Fr, 10Fr i 12Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 13

6. Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo, prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów:

1. Igły do punkcji transseptalnej

- dostępne dwie różne krzywizny BRK, BRK1
- dostępne trzy różne długości: 56, 71, 89cm
- igła wykonana całkowicie ze stali
- dostępna igła typu XS (ekstra ostra) do łatwiejszego nakłucia przegrody

2. Koszulki transseptalne

- średnica 8F: 8,5 F i 10 F
- dostępne 2 różne długości 62 i 80 cm
- w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz przewodnikiem
- dostępne krzywizny do wyboru: T1/T0 oraz T2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu o powyższej charakterystyce

dotyczy projektu umowy

7. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3 „Projekt umowy nr 2” do SIWZ, poprzez dodanie do par. 4 ust. 4 pkt g) w brzmieniu: „Wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu przez Zamawiającego.”.

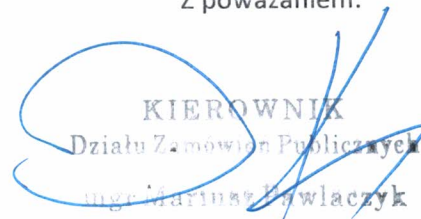
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy poprzez dodanie do § 4 zapisu o powyższej treści.

8. Czy w ramach wykonania umowy zamawiający będzie powierzał wykonawcy jakiegokolwiek dane osobowe swoich pracowników lub zaistnieje konieczność powierzenia zamawiającemu przez wykonawcę danych osobowych pracowników wykonawcy? Jeżeli tak, czy zamawiający zgodzi się dodać do załącznika nr 3 „Projekt umowy nr 2” do SIWZ par. 9 o treści:

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie powierzał wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych swoich pracowników nie zaistnieje również konieczność powierzenia zamawiającemu przez wykonawcę danych osobowych pracowników wykonawcy .

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Powlacznyk